


7.2.3. สถานพยาบาลมีระบบวิทยุคมนาคมที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีความพร้อมในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

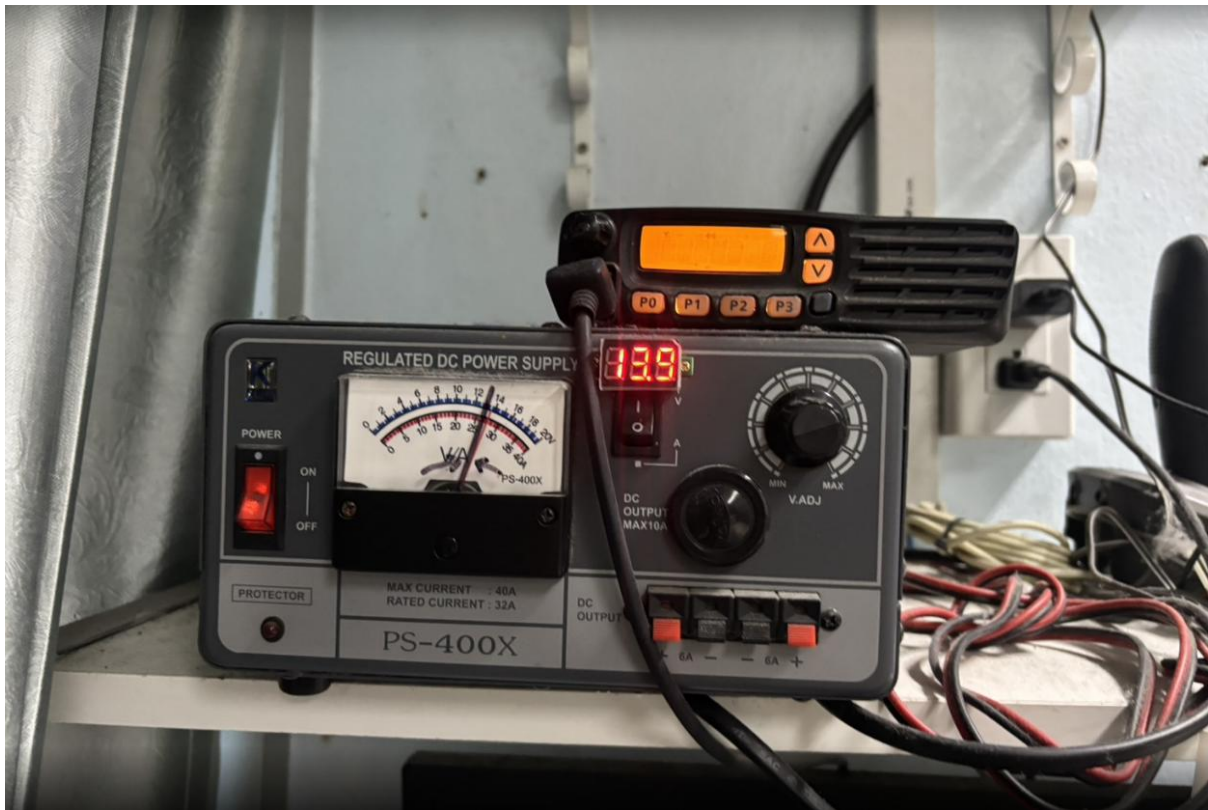

การดูแลรักษา HYT TC-๕๘๐/MS marshall MS-๑/ HIMAX X-๕

ลำดับ	รายการ/ ตรวจเช็ค	ผู้ตรวจเช็ค	HYT TC- ๕๘๐ (๑)	HYT TC- ๕๘๐ (๒)	marshall MS-๑	HIMAX X-๕ (๑)	HIMAX X-๕ (๒)	HIMAX X- ๕ (๓)	HIMAX X- ๕ (๔)
๑	ทำความสะอาด								
๒	ดูตู้ฝุ่น								
๓	ตรวจเช็ค แบตเตอรี่								