


สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

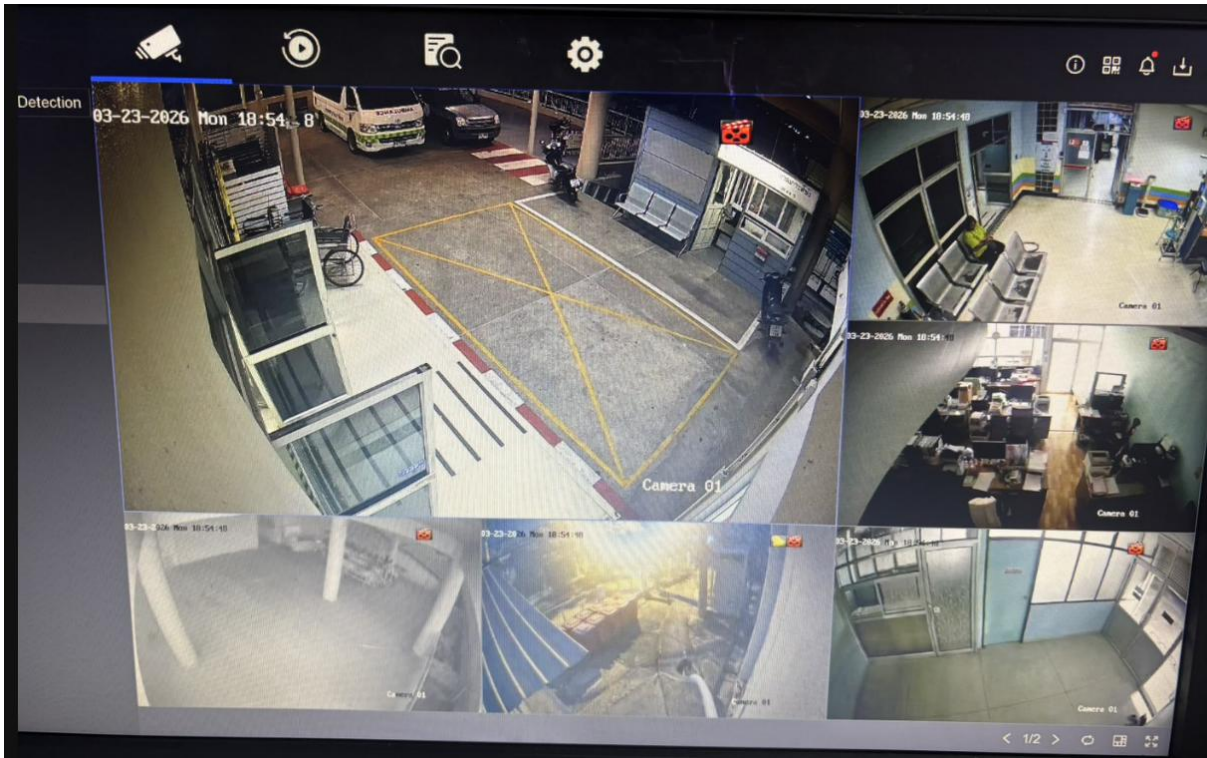

มีตารางการตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของกล้องวงจรปิด

ประจำเดือน.....

การดูแลรักษา ICOM IC-๒๒๕H

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปุ่มสวิตช์/สายไฟ	
๒	ฟิวส์	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ตรวจเช็ค BATTERY	

การดูแลรักษา HYT TC-๕๘๐/MS marshall MS-๑

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	HYT TC-๕๘๐ (๑)	HYT TC-๕๘๐ (๒)	marshall MS-๑	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	จุดฝุ่น				
๒	ทำความสะอาด				
๓	ตรวจเช็ค BATTERY				

การดูแลรักษาเสียงตามสาย

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่

๑	ปั๊มสวิตช์/สายไฟ	
๒	ขั้ว JACK	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ทำความสะอาด	
๕	เช็คความตึงลำโพง	
๖	สัญญาณรบกวน	
๗	อุปกรณ์ต่อพ่วง/ไมโครโฟน	

การรักษาระบบตู้สาขาภายใน โรงพยาบาล

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปั๊มสวิตช์/สายไฟ	
๒	พิวส์	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ตรวจเช็ค BATTERY	

การดูแลระบบ LAN/HUB/INTERNET/กล่องวงจรปิด

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/วันที่
๑	ปั๊มสวิตช์/สายไฟ	
๒	HUB	
๓	จุดฝุ่น	
๔	ตรวจเช็ค BATTERY UPS	
๕	สัญญาณ INTERNET	
๖	กล่อง	